
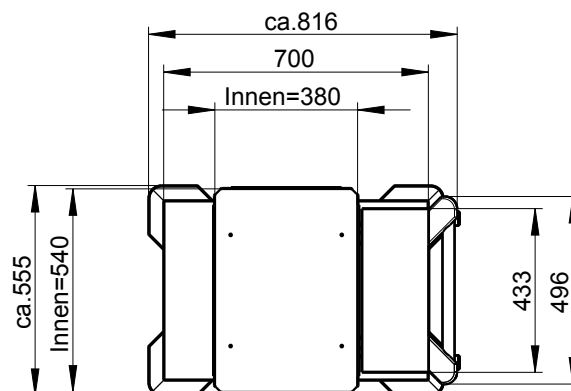
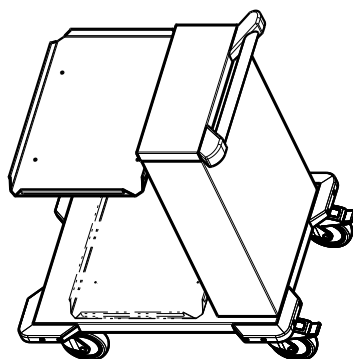
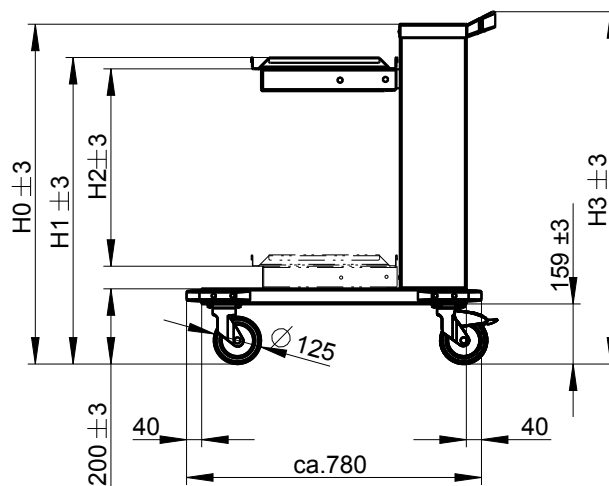


© This drawing may without our consent neither duplicated, still third persons submitted or handed over. Offences can after §18 of the law over mean competition criminal pursuit to involve.

Ausgedruckte Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst!
Printed Drawing is not automatically updated!

Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfältigt, noch dritten Personen vorgelegt oder ausgehändigt werden. Zuwiderhandlungen können nach §18 des Gesetzes über unlauteren Wettbewerb strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

Diese ZEICHNUNG unterliegt NICHT dem ÄNDERUNGSDIENST

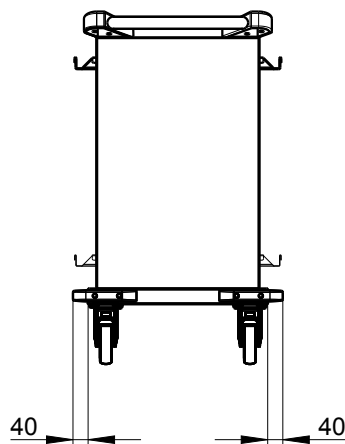

900	1000	911	622	1031
800	900	811	522	931
Stapelhöhe	H0	H1	H2	H3

1	322.103.17	Tabelle hinzu						13.12.2017		Steinhäuser		
Index	Änd.-Nr./Rev.-No.	Änderungsbeschreibung / description of modification						Datum / date		Name / name		
Nicht tolerierte Maße nach non tolerated dimensions acc. to ISO 2768-1 mittel Form- und Lagetoleranzen nach geometric tolerances according to ISO 2768-2-K		Maßstab scale	M 1:20	Bereich Group	100	Status	FR	Unterlagenart document type	AZ	DIN-Format std. paper-size	A4	
		Werkstoff / material nach Stü.Li.						Oberfläche / surface				
		Datum / date		Name / name		Dokument-Nr. document-no.						
		gezeichnet/drawn		13.12.2017		EXSTEINHAA		1000063537,000,02				
		geprüft/checked		13.12.2017		EXSTEINHAA		zugewiesene Mat.-Nr. assigned item-no.				
		genehm./approved		13.12.2017		EXSTEINHAA		00362746				
		Benennung / description						Bemerkung / notice				
		Tablettspender CCE 54/38 INMOTION						Ursprung / origin				
		Ersatz für / replacement for						Blatt / sheet		1	von / of	1

BLANCO
PROFESSIONAL

BLANCO Professional
GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Deutschland